

*Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в паспорте возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надёжность и долговечность изделия.*

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Поставщик:

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»  
105318, г. Москва,  
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 10  
тел.: +7 (495) 136-74-22  
e-mail: info@gank4.com  
<https://www.gank4.ru>

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	1
2. Назначение.....	2
3. Конструкция .....	2
4. Подготовка к работе .....	2
5. Комплектация .....	3
6. Условия эксплуатации. Меры безопасности. Срок хранения.....	3

### 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит описание Фильтра пылевого ФП-1 предназначенного для очистки анализируемого воздуха от мешающих примесей, пыли и масляных паров при использовании газоанализатора универсального ГАНК-4, а также сведения, необходимые при эксплуатации.

### 2 НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр пылевой ФП-1 предназначен для использования газоанализатора ГАНК-4 при проведении измерений вредных веществ в запыленной среде, кроме случаев, когда осуществляется измерения ПДК пыли.

При выполнении измерений различных компонентов (NO, NO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, Si<sub>2</sub> и др., кроме пыли) в запылённой среде (запылённый цех) необходимо устанавливать на входной штуцер газоанализатора фильтр полевой ФП-1 (ОБНУЛЕНИЕ и выполнение измерений проводить с фильтром ФП-1)

Процедуру обнуления/установки нуля/ с использованием ФП-1 производят в соответствии с Руководством по эксплуатации на газоанализатор.

### 3 КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно фильтр представляет собой разъемный корпус из двух частей, внутри которого расположен фильтрующий элемент.

В корпус ввернут штуцер ВЫХОД для подсоединения переходника - трубка ПВД, а также штуцер ВХОД для присоединения штатного зонда.

### 4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Переходник на ВЫХОДе фильтра соединить со штуцером ВХОД газоанализатора ГАНК-4.

Переходник на ВХОДе фильтра соединить с трубкой штатного зонда газоанализатора.

Фильтр готов к работе.

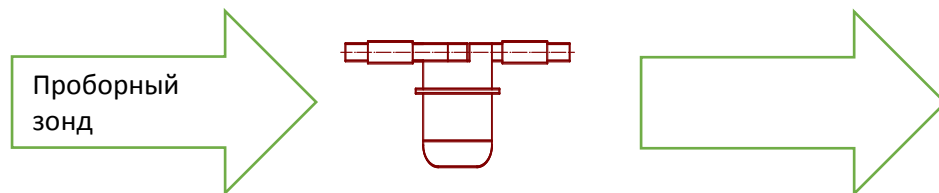


Рисунок 1 – Внешний вид фильтра сорбционного ФП-1

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фильтр пылевой ФП-1	1 шт.
Трубка (переходник) ПВД диаметр 8x1,5 длинна 50 мм	2 шт.
Паспорт	1 шт.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. СРОК ХРАНЕНИЯ.

При соблюдении условий эксплуатации срок эксплуатации фильтра пылевого ФП-1 - 1 год.

Гарантийный срок ФП-1 – 6 месяцев со дня продажи изделия.

При механических повреждениях, нарушениях правил эксплуатации, а также при попадании внутрь фильтра различных жидкостей и других инородных предметов и веществ гарантия не распространяется.

После истечения срока годности и срока эксплуатации для дальнейшей переработки вернуть на завод –изготовитель.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ, НАГРЕВАТЬ, РОНЯТЬ, ПРОТЫКАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ЖИДКОСТИ И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ ВО ВНУТРИ ФИЛЬТРА.**

Для заметок





ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

ПАСПОРТ  
ФИЛЬТР ПЫЛЕВОЙ  
ФП-1

г. Москва